


# ELEKTRODENPLATZIERUNG

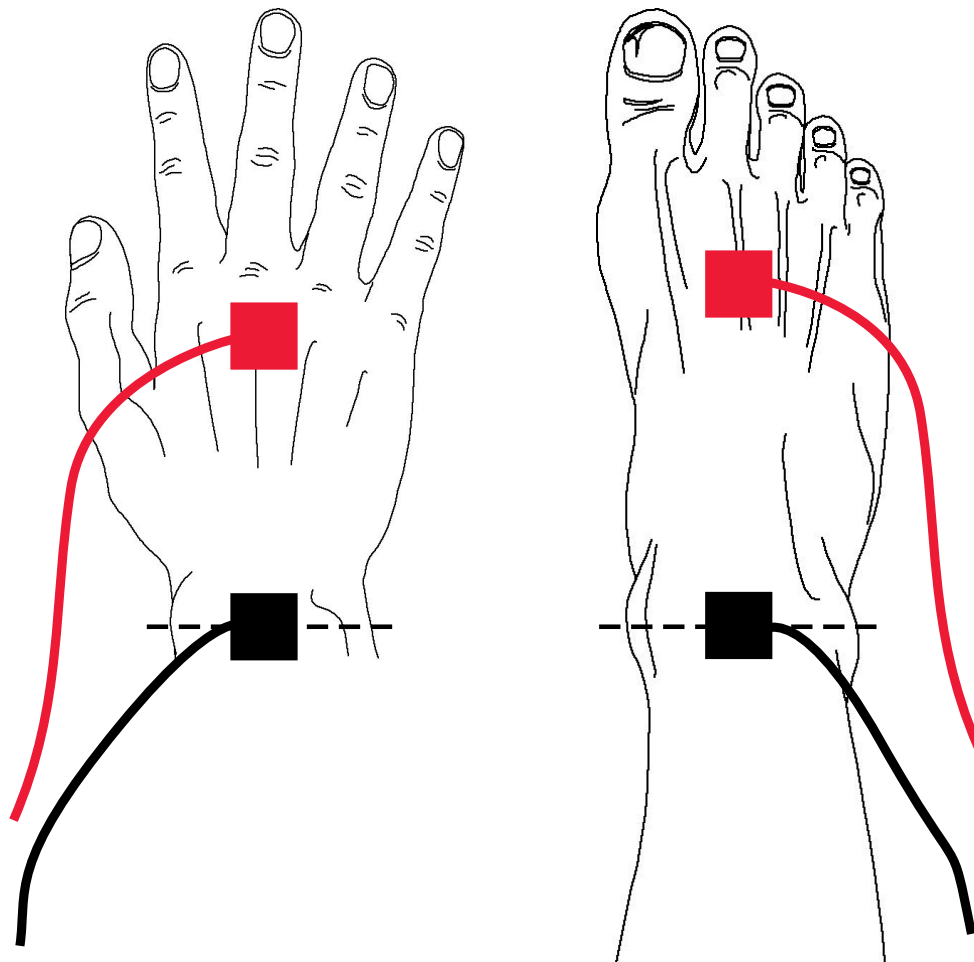

 schwarz: SENSEBLE MESSELEKTRODE

 rot: IMPULS-EINGABELEKTRODE